

管理番号


L40537

再動作確認チェックシート

検査日	2026年2月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	パスボックス	電源・電圧	三相 200V	インターロック	有り
型式	FY-17CST-B	周波数	50・60 Hz	外寸	W600 D740 H1800
メーカー名	松下精工松下電器	ドア枚数	2枚	内寸	W600 D600 H600
機械Ser,No	-	センサー	無し	重量	170 kg
-	-	ドア開閉	手動	-	-

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

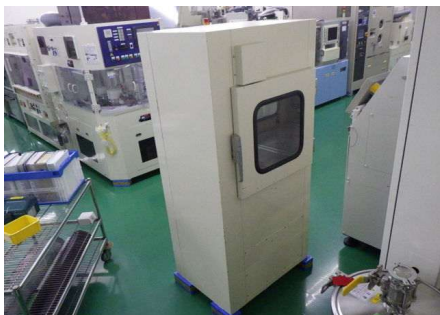

インターロック動作確認済み

タイマー動作確認済み

清浄度測定(0.3 μ m)

1分測定→2600

動作異常無し

明書(無)

※1 多少の擦り傷等有り 動作に支障ありません

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.0H]

検査担当者[金子]



ユーザー名【】出荷日 年 月 日