

N50273

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオナイゼーションモニター	電源電圧	DC12V 1A	測定電圧	0～±1100Vmax
製造年月	不明	ACアダプタ	AD-12N	測定プレート	15×15cm
メーカー名	トレック	型名	156A		20pF(±2pF)
除電ブロー部	W130×D300×H150	Ser.No.	1064	付属	アルミケース

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	※○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC(済・未対象・NG) TP(済・未対象・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1、外観及び通電確認実施。→外観問題なし。

→通電確認は各機能スイッチ及び表示問題なし。※但し、内部バッテリー(7.2V特殊品)の充電ができない。


2、除電モニター確認実施。→測定プレート電圧確認と除電動作確認問題なし。

(除電確認: 中央付近、距離300mm、風量最大時と最小設定時。)




除電ブロー	風量最大	最小
除電時間確認		
+1000V→+100V	0.8秒	1.4秒
-1000V→-100V	1.0秒	1.6秒

除電時間: 約±1000V→100Vになるまでの減衰時間(目安時間)

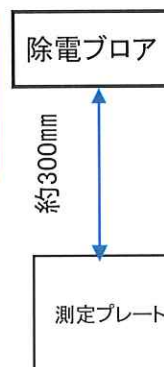

プレート電圧測定			
154Aモニター表示(プレート電圧)		測定器: MODEL-750モニター表示	
プラス電位V	マイナス電位V	プラス電位KV	マイナス電位KV
000	000	0.00	0.00
120	125	0.11	0.12
512	485	0.51	0.49
875	853	0.87	0.86
1017	1008	1.02	1.01

バッテリー劣化

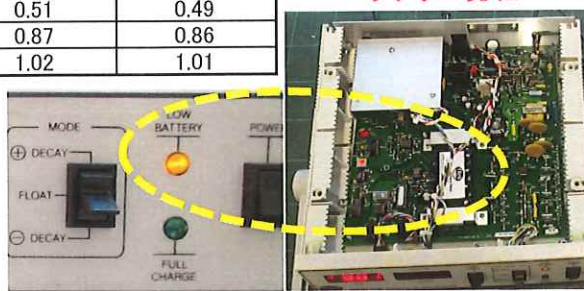

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H] 但し、内部バッテリー劣化している。

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

(条件付きOK)