


O30684

動作確認チェックシート

検査日	2025年5月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	三相 200V	冷却方法	水冷
型式	SDE603A-082	周波数	50/60 Hz	積算時間	33926.7 h
メーカー名	榎山工業	吸気フランジ	NW80	モーター定格出力	6.2 kw
機械Ser.No	05G382	排気フランジ	NW40	排気速度	10000 L/min
製造年月	-	規格値(到達圧力)	1.6 Pa	重量	280 kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○

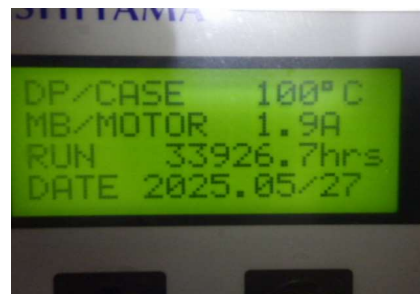

暖気運転1時間30分データ

DPモーター電流値: 8.3A

MBモーター電流値: 1.9A

DPケーシング温度: 100°C

積算時間: 33926.7 h

※到達圧力: 0.32 Pa

取扱説明書(無) * 暖気運転1時間30分後、再起動時の到達圧力です。 特に異常有りませんでした。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[金子]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

