




動作確認チェックシート

検査日	2024年 5月 28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	メモリハイコーダ	電源電圧	AC100~240V DC10~28V	測定機能	メモリコーダ(高速記録) レコーダ(実時間記録) 実効値レコーダ(商用電 源用) FFT(周波数解析)
型式	8841	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日置電機	大きさ(W×D×H)	280×140×300mm		
機械Ser.No	1236017	チャンネル数(最大)	アナログ16ch ロジック16ch	入力ユニット (4スロット)	①:②:8937 電圧・温度ユニット ③:8946 アナログユニット ④:8936 アナログユニット
製造年月	不明(2000年?)	記録部	216mm×30m ロール型感熱紙		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 接続コードは「9198接続コード」が10本付属。ロジックプローブ等は付属なし。
- 2 「システム6」画面で各セルフチェックを実施、問題なし。
- 3 測定機能が多岐なため、4つの入力スロットの各1カ所(CH1, CH3, CH5, CH7)にDC電源を接続して可変させ、レコーダファンクションにて簡単な測定を確認した。特に問題なし。
- 4 たまに液晶画面に縦縞模様がはいる時あり。

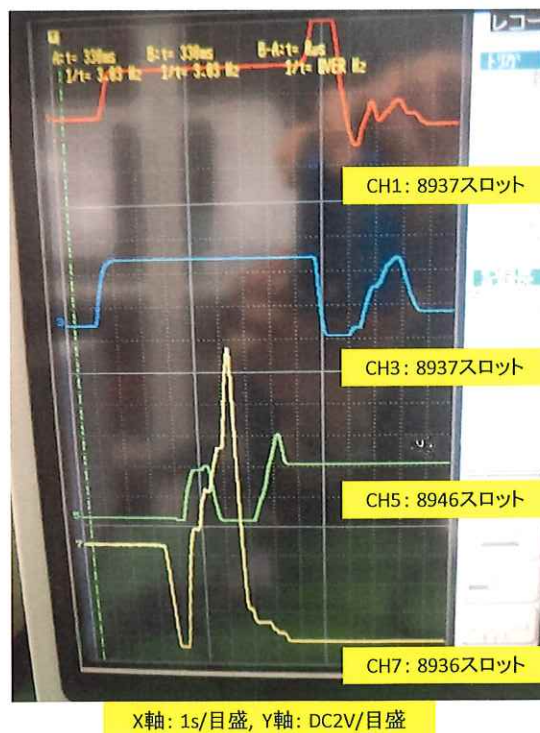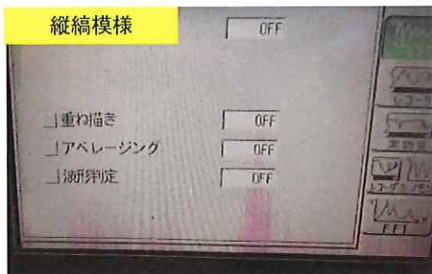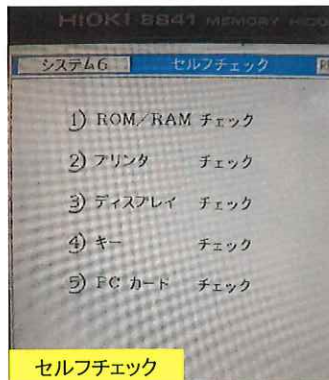

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[野沢]

(備考欄コメント)

ケース収納品です。

[責任者]

