

管理番号

Q51065

動作確認チェックシート

検査日	2026年6月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ピラニ真空計	電源	AC90～120V	外寸	90×160×100
型式	GP-1SRY	周波数	50/60Hz		
メーカー名	アルバック	測定範囲	0.4 ～ 2700Pa		
機械Ser.No	69256	測定範囲	0.003 ～ 20Torr		
製造年月	—	質量	2Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

【 検査環境 】


- * 社内用 : 排気セット(RP+TMP) * RPのみ使用
- * 社内用 : ULVAC製 ピラニー真空計 ISG-1 / ULVAC製 測定子SW1-1にて測定
- * Q51065 : ULVA製 ピラニー真空計GP-1SRY / 動作確認用 ULVAC製 測定子(WP-02)にて測定



* (比較計):ISG-1 測定値:1.2Pa

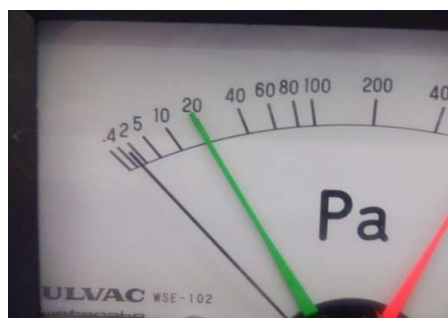

*(Q51065)GP-1SRY測定値:約 1.0Pa

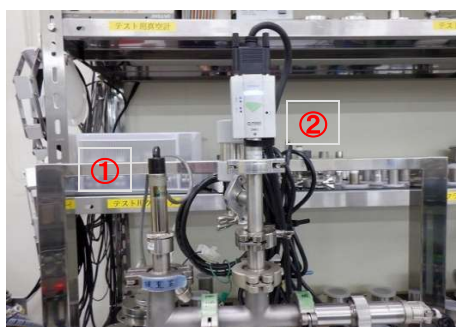

①(比較検査用測定子:WP-02)

②(比較計) 測定子:SW1-1

取扱説明書(無)

* 測定時に針振れ等も無く正常に測定を完了しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2026年6月2日	配線(保護チューブ処理実施)	立野

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5 H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

