管理番号

Q63157

動作確認チェックシート

検査日	2026年7月24日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	超音波洗浄機（卓上）	電源電圧	1相　100V	最大電源容量	405W
型式	MH5800H-J	周波数	50/60 Hz	外形寸法	W398 D398 H381
メーカー名	ヤマト科学（ブランソン）	発振周波数	40kHz	タンク寸法	W301 D240 H150
機械Ser,No	BHH041374280	最大超音波出力	160W	タンク容量	9.5L
製造年月	2013年　4月	ヒーター容量	200W	重量	6.9kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	~~PLC（済・未対象・NG）　TP（済・未対象・NG）　BT交換（済・未）~~	


備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境：　室温25.4℃、湿度56.8%RH

社内測定器：ホンダ電子 HUS-5を使用

■ **外観　・・・　異常なし**



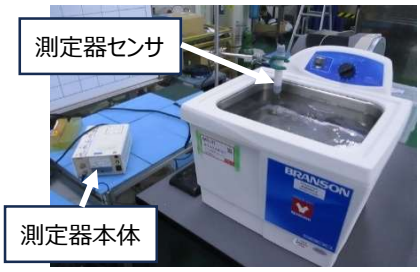

■ **通電確認**

・インジケーター類等は何もなし

・電源ONし水温上昇することを確認

※ヒーターは電源ONと同時に入る仕様。尚、60℃超で自動OFF

■**超音波強度の測定**

※水位は「OPERATING LEVEL」まで注水

洗浄槽内を左図の様に9区画に見立てそれぞれの中心位置において強度を測定実施（底面より20mm高さで計測）

①	④	⑦
②	⑤	⑧
③	⑥	⑨





①	10.0mV	④	13.0mV	⑦	11.0mV
②	10.0mV	⑤	12.5mV	⑧	12.0mV
③	10.0mV	⑥	12.5mV	⑨	10.5mV

※上記全てのエリアにおいて10mV以上あることを確認

取扱説明書（有）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK）　作業工数[　3H　]

検査担当者[　Kugizaki　]

ユーザー名【　　】　出荷日　　年　　月　　日