管理番号

Q83126

動作確認チェックシート

検査日	2026年 10月 14日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	電子天秤	電源電圧	1相　100V	最小計量値	0.2g
型式	AP224X	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	島津製作所	最大ひょう量	220g	皿径	91mm
機械Ser,No	D315601454	最小表示	0.0001g	寸法	W212 D367 H345
製造年月	2021年　月	校正分銅	内蔵	重量	7kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	
3	SW設定	SWの機能は正常か。	
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	
6	データバックアップ	PLC（済・未対象・NG）　TP（済・未対象・NG）　BT交換（済・未）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境：室温21℃、湿度68%RH　　使用社内基準分銅：村上衡器製作所

■ **外観** ・・・ 異常なし



■ **通電**

・電源ONと同時に自動的に通電チェックと感度調整動作

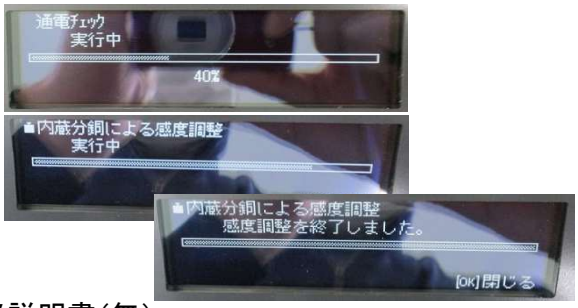

■ **確認実施内容**

・繰返し再現性、・分銅皿位置、・直線性

200g 繰返し	
1	200.0009
2	200.0008
3	200.0006
4	200.0009
5	200.0007
6	200.0008
7	200.0007
8	200.0008
9	200.0008
10	200.0008
max	200.0009
min	200.0006
bal	0.0003
3σ	0.000276

100g 四隅	
中央	100.0040
左	100.0038
上	100.0040
右	100.0042
下	100.0041
max	100.0042
min	100.0038
bal	0.0004
3σ	0.000445

四隅位置



直線性		
0	0.0000	
50	50.0002	
110	110.0041	
170	170.0043	
220	220.0009	
R^2	1.000000	
傾きと切片	1.000011	0.000691

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　　作業工数[　3h　]

検査担当者[　Kugizaki　]

ユーザー名【　　】　　出荷日　　年　　月　　日